




2021年3月号
1/6


ホリコ



「ホリコ カーバイドバー」

モデルチェンジ・新商品のご案内


インプラントの角度と位置を修正 強度・切削力アップ！ 深度がみえる！チタンコーティング

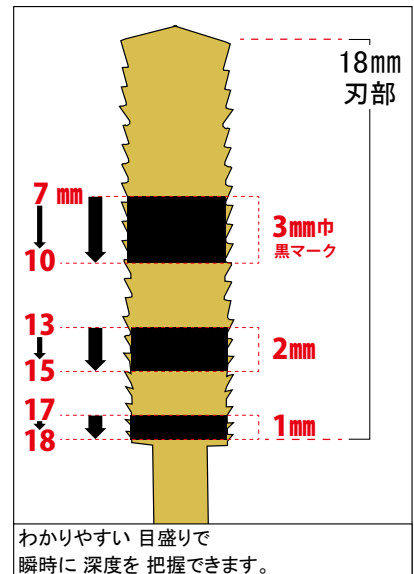

- 発売日：2021年3月29日(月)
- 販売名：ホリコ カーバイドバー
- クラス分類：一般(I) ● 医療機器届出番号：28B1X00005000290

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
08615	インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ2.0	1		04560195458773
08616	インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ2.5	1		04560195458780
08617	インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ3.0	1		04560195458797
08618	インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド 3本セット	3		04560195458803

(従来品シルバー色にゴールドコーティング加工をプラスしたモデルチェンジです)



ホリコ

「ホリコ カーバイドバー」

完売・在庫限り / モデルチェンジのご案内


長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。



完売

- 販売名: ホリコ カーバイドバー
- クラス分類: 一般 (I) ● 医療機器届出番号: 28B1X00005000290

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
08611	インプラント用 サイドカッティングバー φ 2.0	1	[完売] 代替品: インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ 2.0	04560195458698
08614	インプラント用 サイドカッティングバー 3本セット	3	[完売] 代替品: インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド 3本 セット	04560195458728



在庫限り

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
08612	インプラント用 サイドカッティングバー φ 2.5	1	[在庫限り] 代替品: インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ 2.5	04560195458704
08613	インプラント用 サイドカッティングバー φ 3.0	1	[在庫限り] 代替品: インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ 3.0	04560195458711

代替品

- 発売日: 2021年3月29日(月)

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
08615	インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ 2.0	1		04560195458773
08616	インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ 2.5	1		04560195458780
08617	インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド φ 3.0	1		04560195458797
08618	インプラント用 サイドカッティングバー ゴールド 3本セット	3		04560195458803

ポリラピッド
Polirapid

「**ポリラピッド 研磨用器材**」

完売 / 代替品のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。


完売

- 販売名:ポリラピッド 研磨用器材
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000294

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
42047	ロビンソンブラシ 平 RA 110 19mm	12	[完売] 代替品:ロビンソンブラシ 平 HP 110 19mm	04580195070904

代替品

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
42048	ロビンソンブラシ 平 HP 110 19mm	12		04580195070911


	<p>「デデコ アブレスブ研削器具」</p> <p style="background-color: #c8e6c9; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">完売 / 入数変更のご案内</p>
---	---

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

完売

- 販売名: デデコ アブレスブ研削器具
- クラス分類: 一般(I) ●医療機器届出番号: 28B1X00005000284

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
43029	インタープロキシマルホイール4991	25	[完売] 22mmグリーン 代替品: インタープロキシマルホイール5991	04580195071437



入数変更品

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
43030	インタープロキシマルホイール5991	100	22mmグリーン	04580195071444

<p>ジッペラー ↓ オロチ</p>	<p>「ジッペラー カーバイド バー」</p> <p style="background-color: #d9ead3; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">完売 / 代替品のご案内</p>
--	--

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ジッペラー カーバイドバー全規格ともに在庫限り品として、完売次第丈夫でよく切れる オロチ カーバイドバーの同規格へと切り替えて参ります。

また、バー以外のWAX・ペーパーディスクは製造販売を継続しております。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

完売


- 販売名:ジッペラー カーバイド バー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000089

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
17204	HP 2	6	[完売] 代替品:オロチ カーバイドバー HP 2	04580195086585
17206	HP 4	6	[完売] 代替品:オロチ カーバイドバー HP 4	04580195086608

代替品


- 販売名:オロチ カーバイドバー
- クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000343

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
73175	HP 2 2piece 合着型	5		04571197458685
73177	HP 4 "	5		04571197458708

	<p>「セラダイヤモンド スターターキット」</p> <p style="background-color: #d4edda; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">バースタンド同梱中止のご案内</p>
---	--

アメリカからの包装簡素化により、バースタンドなしにて出荷申しあげます。
製品・価格・GS1コードに変更はございません。

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
 ご理解・ご了承を賜りますようお願い申しあげます。

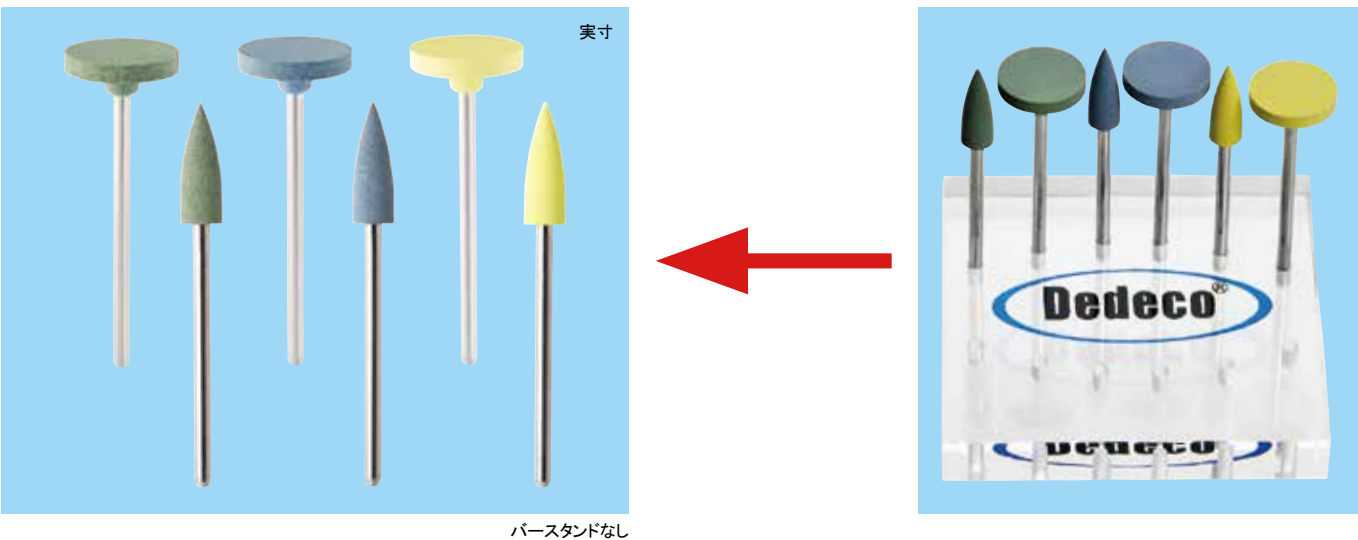

- 販売名: デデコ ダイヤモンド切削器具
- クラス分類: 一般(I) ●医療機器届出番号: 28B1X00005000285

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
43451	セラダイヤモンド スターターキット	6	バースタンド付	04571197441069